

一氧化碳检测报警仪(电化学法)出厂检验报告

生化仪机型: DS-401

生化仪编号: DS1KS001

检测原理: 电化学法

检测范围: 0~100ppm

检测精度: ±1%

型号	规格
DS-401	0~100ppm 电化学法

检测项目: 一氧化碳浓度

检测日期: 2018年10月10日

检测地点: 生产车间

检测人员:

张三

检测时间:

2018年10月10日

检测地点:

生产车间

检测结果:

一氧化碳浓度

检测数据:

0.0000

检测结论:

合格

检测备注:

在规定的检测范围内, 检测结果符合标准要求。

检测项目:

一氧化碳浓度

检测数据:

0.0000

浓度1

2.83%

浓度2

0.86%

浓度3

2.83%

浓度4

1.81%

浓度5

3.40%

检测结论:

合格

符合要求

检测备注:


在规定的检测范围内, 检测结果符合标准要求。

检测项目:

一氧化碳浓度

检测结论:

合格

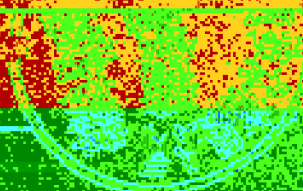

检测日期:

2018年10月10日

检测地点:

生产车间